



TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Ilustríssimo (a) Senhor (a), pregoeiro (a)

Membros da comissão de licitação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA

Ref. EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

Do Objeto: Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médicohospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

A **TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.002.975/0001-75, sediada na Rua Marechal Rondon, 184 – Planalto – Belo Horizonte/MG, vem, tempestivamente, com o devido acato, a presença de Vossa Senhoria para apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** do edital de pregão epigrafado, com base nos fatos e fundamentos adiante dispostos.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foram verificadas a existência de questões que necessitam de esclarecimentos, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que reste infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I – DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

O item 11 do edital ora em comento, especifica que os pedidos de esclarecimentos referente ao processo licitatório deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da licitação, por meio eletrônico.

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através de envio para o e-mail licitacao@cisru.saude.mg.gov.br.

II – DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

O Edital em seu anexo I, apresenta os seguintes descritivos para os itens 1,2,3,4, 5 e 6:



TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO				
1	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 14 - Dispositivo de punção intravenosa periférica Nº 14, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a NR 32 com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL MAIS FILME.	3	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 18 - Dispositivo de punção intravenosa periférica Nº 18, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a NR 32 com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL MAIS FILME.	5	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 22 - Dispositivo de punção intravenosa periférica Nº 22, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a NR 32 com proteção total da agulha, controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL MAIS FILME.
2	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 16 - Dispositivo de punção intravenosa periférica Nº 16, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. Cateter em biomaterial Vialon de acordo com a NR 32 com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, sinalização da punção por retorno de sangue, controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão para fora do canhão no ato da primeira punção. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL MAIS FILME.	4	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 20 - Dispositivo de punção intravenosa periférica Nº 20, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a NR 32 com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL MAIS FILME.	6	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 24 - Dispositivo de punção intravenosa periférica Nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a NR 32 com proteção total da agulha, controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL MAIS FILME.

Através dos mesmos é possível verificar que em todos os dispositivos solicitados é requisitado que contenham um biomaterial patenteado exclusivo de uma determinada marca e cita como se fosse pré requisito contido na NR32.

O Vialon, biomaterial citado patenteado pela BD por: Tecnologia BD Vialon™, se apresenta como sendo um biomaterial clinicamente testado e que reduz as complicações relacionadas ao cateter.



Os benefícios apresentados pela empresa são em comparação à um dispositivo confeccionado a partir de Teflon onde se perceberia a eficiência máxima do biomaterial como demonstrado nas imagens abaixo retirada do catálogo disponibilizado pela empresa:

Tecvida comércio e distribuição LTDA.

Rua: Marechal rondon, 184 Planalto Belo Horizonte/MG CEP:31720-050
CNPJ:11.002.975/0001-75 Tel: (31)34951482 Fax: (31) 32342072



TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

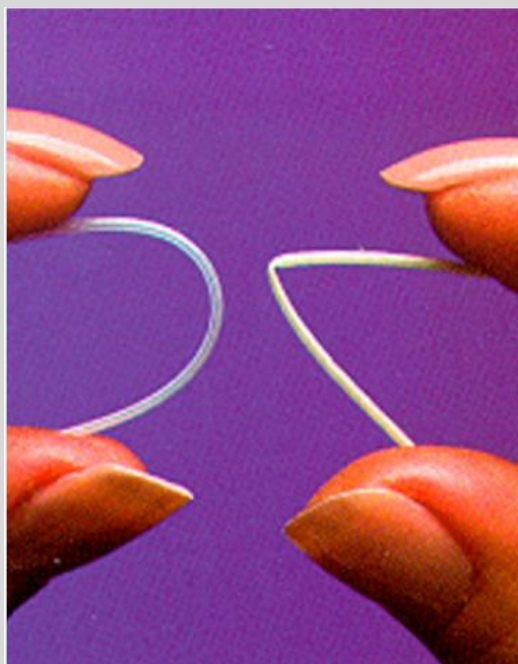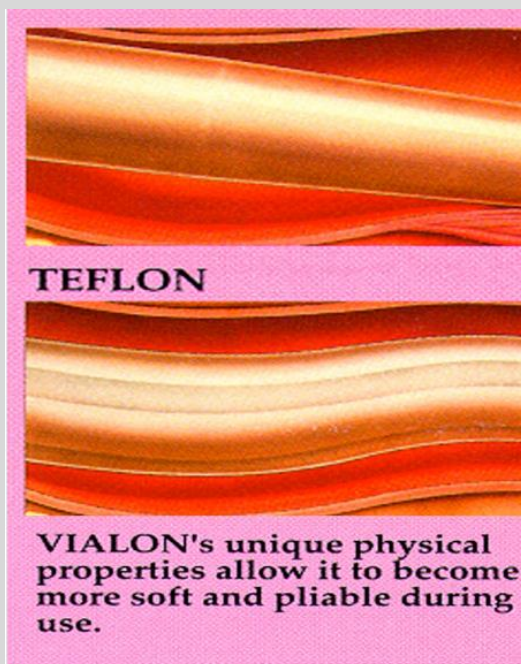

TEFLON x VIALON

A detentora da tecnologia ressalta que dentre os benefícios característicos dos mecanismos de ação do seu produto os que lhe conferem vantagem ímpar são: Maior velocidade de fluxo em relação à cateteres de Teflon e flexibilidade do biomaterial quando em contato com revestimento interior da veia causando menos irritação na mesma reduzindo o desconforto na inserção.

Tendo em vista os fatos supracitados a empresa Tecvida Comercio e Distribuição LTDA, vem através deste salientar que atualmente o mercado conta com material que possui equivalência no mecanismo de ação embora não seja da marca supracitada.


O cateter Healcath Autosaf da marca Harsoria, é um dispositivo com uma agulha trifacetada chanfrada para penetração mais rápida e relativamente indolor no momento da punção. O ângulo de trabalho entre 15° e 35° proporciona uma maior flexibilidade para o profissional de saúde favorecendo o deslize do material através de sua agulha silicionizada com bisel ultra afiado, como pode ser observado nas imagens abaixo:

Tecvida comércio e distribuição LTDA.


Rua: Marechal rondon, 184 Planalto Belo Horizonte/MG CEP:31720-050
CNPJ:11.002.975/0001-75 Tel: (31)34951482 Fax: (31) 32342072



TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

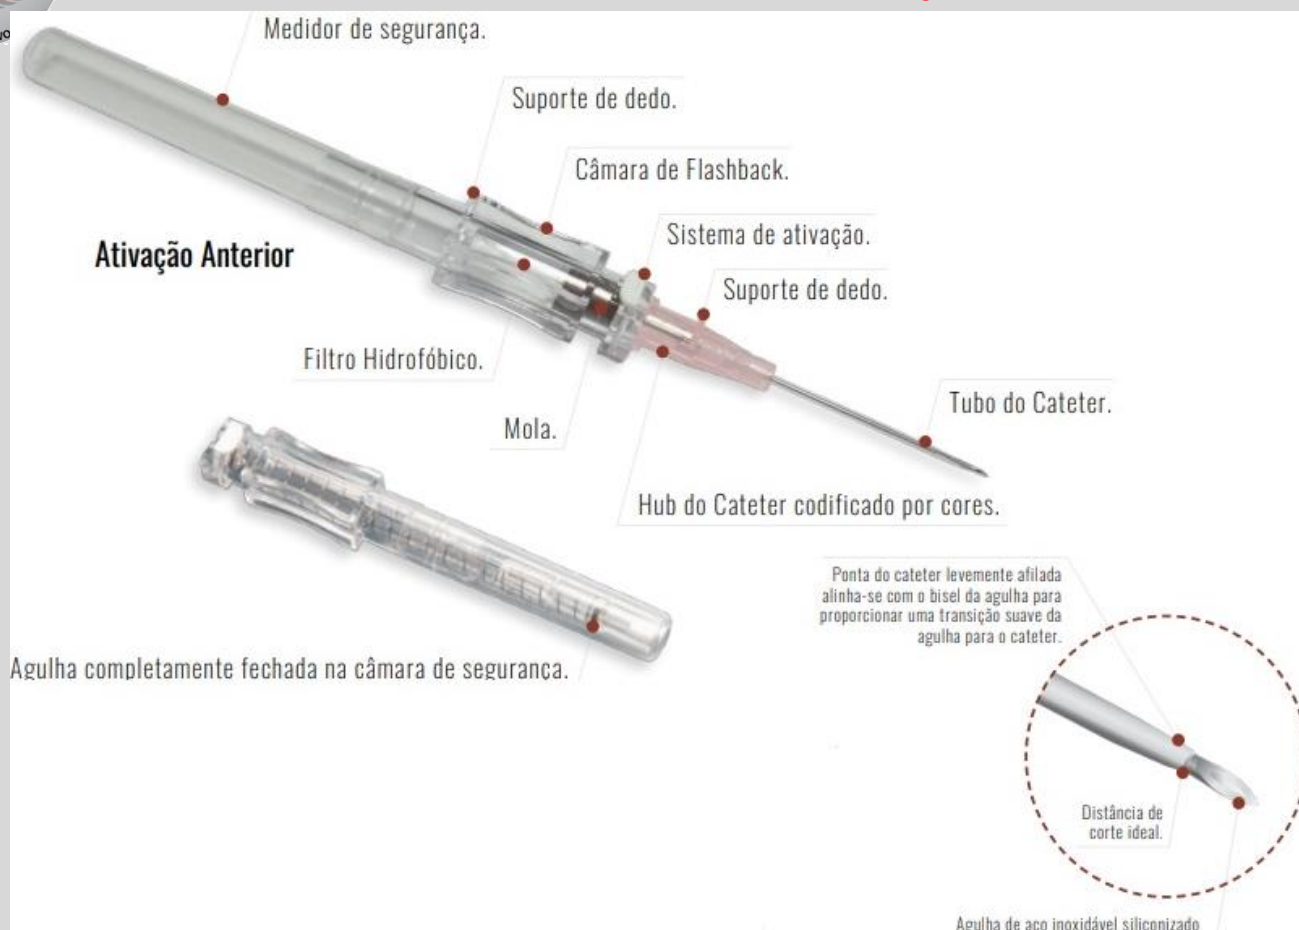

A distância entre a ponta principal e o bisel da agulha é mantida dentro de uma faixa muito estreita para eliminar o risco de o cateter ser puxado para trás ocasionando falha na inserção.

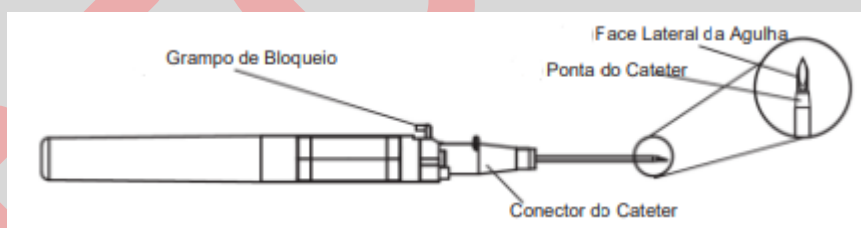



Tecvida comércio e distribuição LTDA.

Rua: Marechal rondon, 184 Planalto Belo Horizonte/MG CEP:31720-050

CNPJ:11.002.975/0001-75 Tel: (31)34951482 Fax: (31) 32342072



TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

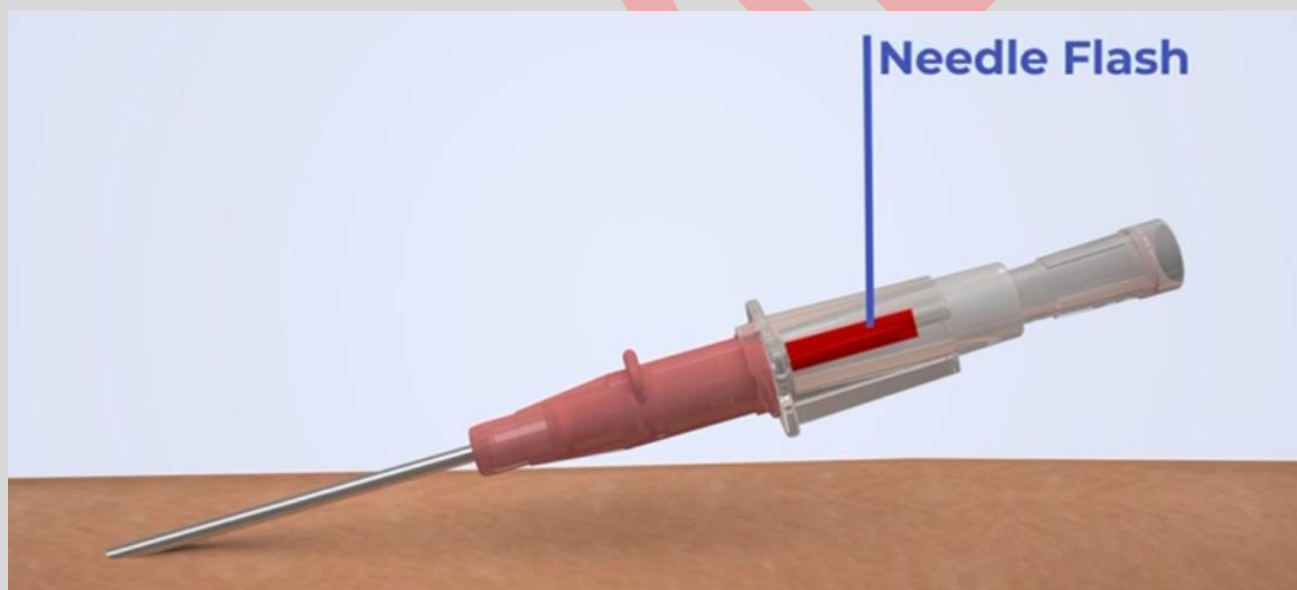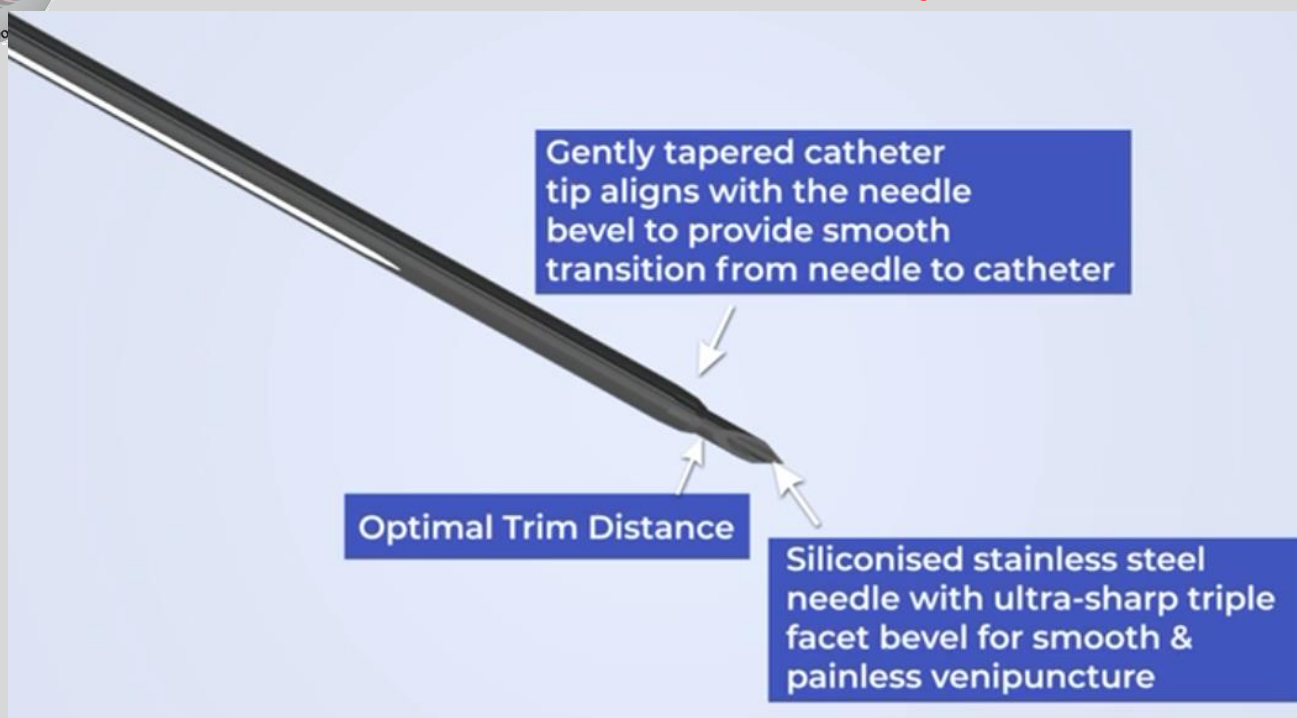

A presença de sangue indica uma punção venosa bem-sucedida. A agulha é retirada em um movimento suave e contínuo enquanto mantém a pressão.

Tecvida comércio e distribuição LTDA.

Rua: Marechal rondon, 184 Planalto Belo Horizonte/MG CEP:31720-050

CNPJ:11.002.975/0001-75 Tel: (31)34951482 Fax: (31) 32342072



TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Safety Shield



Isto elimina o risco de picada acidental da agulha nosp rofissionais de saúde, além idsso a desativação do mecanismo de segurança torna o dispositivo indisponível para reutilização acidental.

III – DA CONCLUSÃO

Frente a todo o acima suscitado, requer que todas as questões supra suscitadas sejam devidamente esclarecidas, no intuito de que o certame licitatório transcorra da forma cristalina e ne melhor forma de direito.

Nestes termos

Pede deferimento

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2024.

LUCIANO COELHO ANDRADE

Sócio Diretor

CPF: 008.207.126.80

Tecvida Comercio e Distribuição Ltda

11.002.975/0001-75

TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

RUA MARECHAL RONDON 184 -

BAIRRO PLANALTO -

CEP: 31.720-050 – BELO HORIZONTE MG

Tecvida comércio e distribuição LTDA.

Rua: Marechal rondon, 184 Planalto Belo Horizonte/MG CEP:31720-050

CNPJ:11.002.975/0001-75 Tel: (31)34951482 Fax: (31) 32342072